


# 检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告

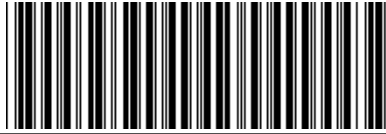

No: 200113152M0

 防伪查询网址: [www.gttc.net.cn](http://www.gttc.net.cn)


防伪码: EYWV-0049-04

共3页 第1页

委托单位	东莞市弗瑞斯生物科技有限公司 地址: 广东省东莞市石排镇石排工业大道5号1号楼201室		
客户认定信息	KN95医用防护口罩 10个 商标: CHOEBE 生产单位: 东莞市弗瑞斯生物科技有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-05-07
		报告签发日期	2020-05-15
判定依据	GB 19083-2010 《医用防护口罩技术要求》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	过滤效率	GB 19083-2010	符合
	气流阻力	GB 19083-2010	符合
备注	更改内容: 更改等级。 本报告代替200113152报告, 同时200113152报告作废。 本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。 复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		



签发: 刘圆 工程师




# 样品图片

(电子版)

No:200113152M0

共3页 第2页

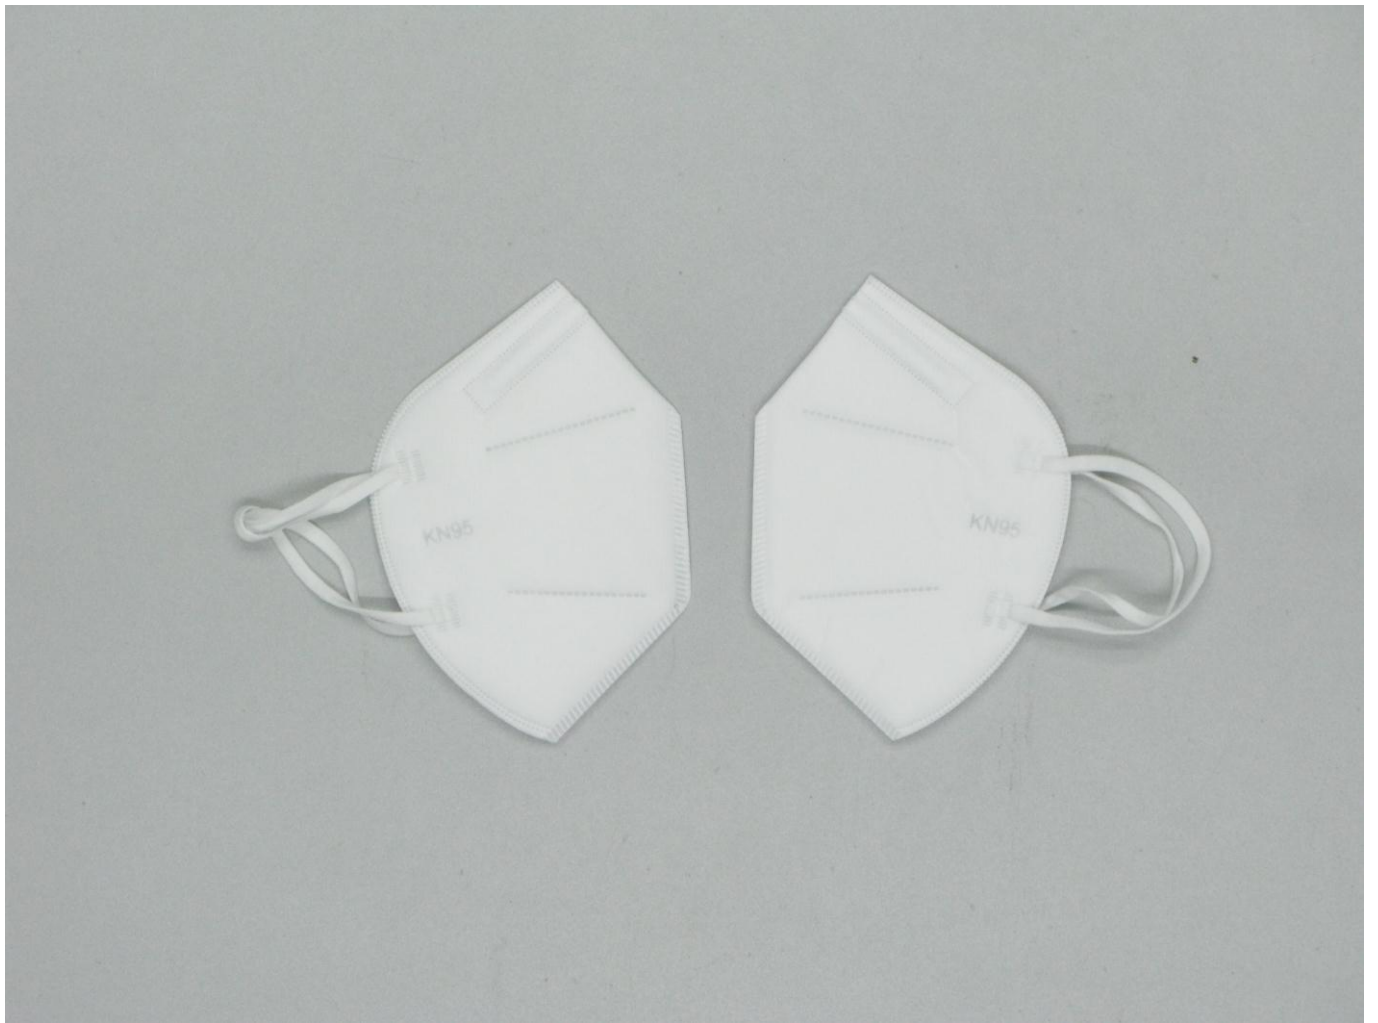

## 检验检测报告附页 (电子版)

No: 200113152M0

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●过滤效率 (%)	GB 19083-2010 5.4 气体流量: 85L/min 气溶胶颗粒: NaCl 气溶胶浓度: 15mg/m <sup>3</sup> 温度: 22.7℃ 相对湿度: 34.5%	≥99 (2级)	最小值 99.238	符合	
●气流阻力 (Pa)	GB 19083-2010 5.4 气体流量: 85L/min 气溶胶颗粒: NaCl 气溶胶浓度: 15mg/m <sup>3</sup> 温度: 22.7℃ 相对湿度: 34.5%	≤343.2	最大值 78.5	符合	
备注	(本栏空白)				



——本报告结束——